3200P 型 pH 计安装

打开 3200P 型 pH 计包装，取出 pH 计、电极支架以及相关附件。

电极支架的安装

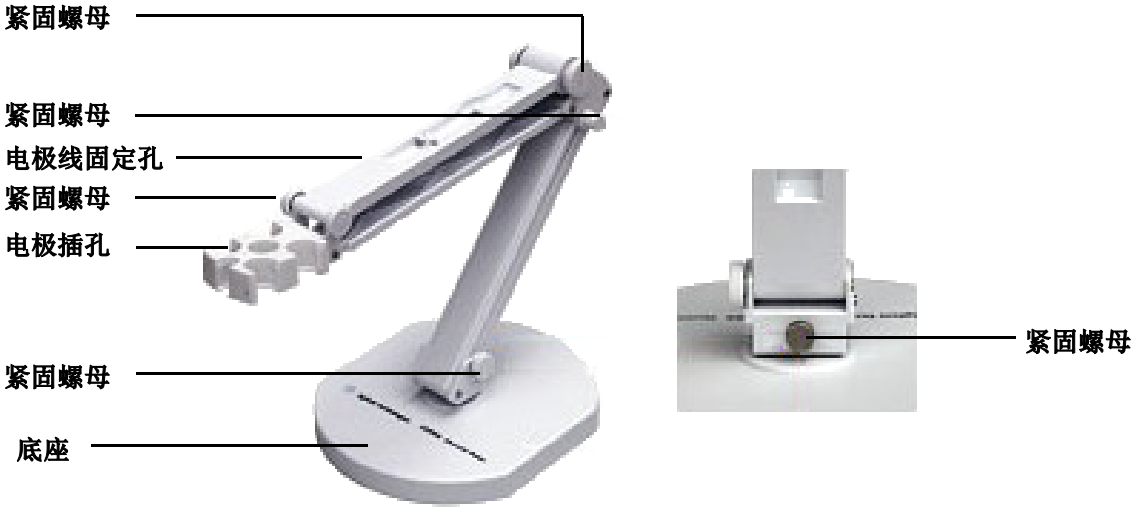

电极的安装

在 pH 计的背面找到 pH/pX 电极接口、温度电极接口，然后，分别将 pH 测量电极、温度电极 （5190-3998）插入相应 pH/pX 电极接口和温度电极接口内，并将电极线夹在电极支架边缘固定孔中。

电源适配器的安装

仪器随机提供电源适配器。请注意，本适配器只适用于本仪器，不建议用于其他类型的仪器。我们也不建议使用其他类型的电源适配器。

本电源适配器适用于以下电源：100~240VAC， 1A， 50/60Hz。

对应不同地区的电源，电源适配器提供多种转接插头，用户请正确选择合适的电源插头，然后按照图示将电源插头安装到适配器底座上，听到“啪”的一声表示已经安装到位。

接地线的安装

仪器随机提供接地线，但是接地线在测量过程中不是必须安装的。有时电极和被测溶液组成的测量部分会受到某些设备的干扰（如恒温槽等设备），从而引起跳字、影响测量，此时必须将测量部分屏蔽起来，并安装接地线，消除干扰。当仪器受到干扰时，将 DC501 接地线一端连接仪器，另一端连接测量部分的屏蔽层，比如恒温槽的外壳等。

安装电化学数据采集软件

本软件是为了方便用户使用而开发的一套数据采集软件（本软件 G4390A 需要另外购买）。如果用户需要，请选择安装。

pH 计安装好后，在计算机上安装电化学数据采集软件，采用 USB 接口连接线可实现与计算机通讯。请参阅电化学数据采集软件的安装说明。

安装数据打印软件

安捷伦为 3200P 型电导率仪提供了免费的数据打印软件。

本软件是为了方便用户使用而开发的。如果用户需要，请选择安装。

数据打印软件界面操作

1 连接仪器电源，按 "On/Off" 键打开仪器。

2 用 USB 连接线连接仪器与 PC 机。

3 在 PC 机运行数据打印软件。

获得更多信息

pH 计和电化学数据采集软件的安装现在已经完成。有关更多信息，请参阅：

1 3200P 型 pH 计操作指南，以获得和熟悉日常操作说明。

2 电极操作指南，以获得电极使用和维护说明。